


# MIG 滅菌過濾系統簡介

# MIG淨水系統家用設備之特色

- 一、證據最重要：嘴巴會騙人，證據會說話。
- 二、濾材要精挑：過濾系統的過濾能力，取決於濾芯材質的優劣。
- 三、水質要夠好：水是喝的，過濾後的水質非常重要『健康無價』。
- 四、專業不能少：完善的電腦客戶管理及專業的維護。
- 五、保障必須高：絕對的保障。

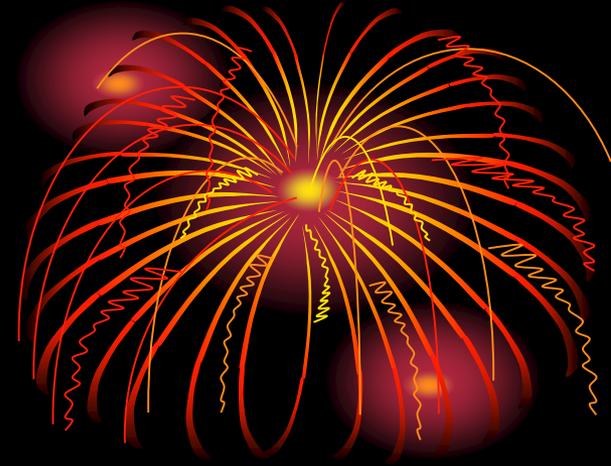

# MIG活水機做到了嗎？


一、證據最重要：嘴巴會騙人，數據會說話。

MIG活水機 從濾芯的材質、水質的驗證、功能的配置、保養的檢測到產品責任的保單都有原廠的數據證明，絕不是只靠吹噓。


二、濾材要精挑：過濾系統的過濾能力，取決於濾芯材質的優劣。

MIG活水機的

前置濾芯



活性碳濾芯



樹脂濾芯



滅菌濾芯



能量濾芯



原廠數據，可證明皆為頂級材質。

三、水質要夠好：水是喝的，過濾後的水質非常重要『健康無價』。

MIG活水機的

32項水質檢測



全國最多。

四、功能不能少：過濾系統的使用不只是為了要喝水。

MIG活水機的

軟水系統



可降低石灰質對人體的影響及機器的傷害。

五、保障必須高：完善的管理，專業的維護，絕對的保障。

MIG活水機的


2000萬(含罰單在內)產品責任險



全國唯一。



# 小分子水檢測報告

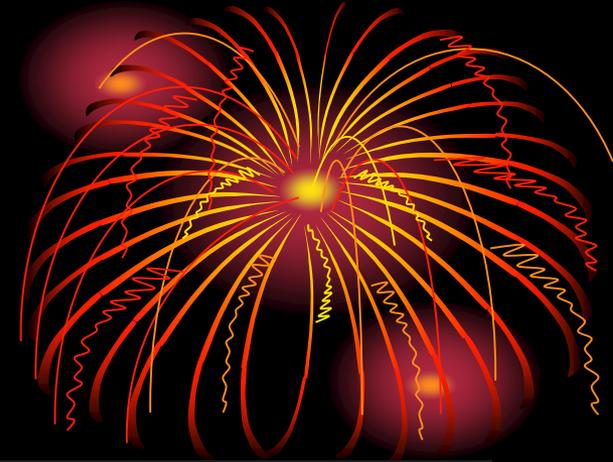

复旦大学分析测试中心实验室

## 检测报告

|   |                                |                                     |            |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 报告编号  | 16042601                       | 委托单位/个人                             |            |
| 送样单位地址  | 捷登國際股份有限公司                     |                                     |            |
| 送样日期  | 2016-04-22                     | 报告发送日期                              | 2016-04-26 |
| 本报告共 1 页 (其中报告正文 1 页; 图、表 0 页)。   |                                |                                     |            |
| 样品名称  | 中池水石<br>高配版弱碱性滤芯水样             | 样品数量                                | 1          |
| 样品状态  | 液体                             | 检测仪器: BRUKER AVANCE DMX 500 核磁共振波谱仪 |            |
| 检测项目  | 17 氧半峰宽                        |                                     |            |
| 检测依据: JY-T 007-1996 超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱方法通则  | 检测环境条件: 室内温度: 20 °C 相对湿度: 50 % |                                     |            |
| 分析测试结果:   |                                |                                     |            |
| 检测指标  | 水样 (中池水石高配版弱碱性滤芯水样)            |                                     |            |
| 17 氧半峰宽   | 45 Hz                          |                                     |            |
| 注: 说明: 1. 本报告任何涂改增删无效, 复印件未加盖本单位印章无效;<br>2. 本报告只对来样负责, 本报告中所涉及的样品及其名称由客户或按其指令执行的第三方所取得或提供, 其结果仅严格与被检测样品相关, 而不担保该样品对于任何货物或产品具有代表性, 我中心不接受与样品的原产地或来源相关的任何责任; 本报告数据仅供委托者使用, 不对第三方构成证明作用。<br>3. 未经本中心同意, 任何单位或个人不得用本报告及本中心的名义作广告宣传。 |                                |                                     |            |
| 检测/复核:  | 王力平、杨宇红/任庆广                    | 2016年04月26日                         |            |
| 地址: 上海市邯郸路 220 号复旦大学分析测试中心科学楼 217 室   | 邮编: 200433                     |                                     |            |
| 电话: 021-65643011  | 传真: 021-65643014               | Email: sqgren@fudan.edu.cn          |            |


说明: 1. 本报告任何涂改增删无效, 复印件未加盖本单位印章无效; 2. 本报告只对来样负责; 3. 未经本中心同意, 任何单位或个人不得用本报告及本中心的的名义作广告宣传。4. 如有异议, 请于报告发出之日起 15 天内前来复核, 逾期不予受理。

## 經分子細小化濾芯過後 NMR核磁共振<sup>17</sup>O檢驗報告

復旦大學分析測試中心 45Hz

新竹工研院非正式報告 78.5Hz

17O NMR 2016/11/15 4  
Width at half height: 78.5 Hz

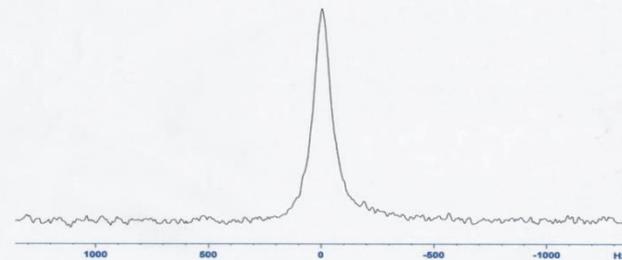

# 案例分享



## 【高雄路竹蛋雞場】



未經過清洗的蛋，已乾淨透亮



明顯改善環境異味、蒼蠅降低



減少雞隻下痢狀況



產蛋質量佳，零售市場價格提升



雞隻減少羽毛掉落之情形



# 欣農畜牧場使用前後對照表




## 存亡率

|      | 產舍隻數  | 死亡數 | 死亡率   | 保育舍隻數 | 死亡數 | 死亡率   | 肉豬舍隻數 | 死亡數 | 死亡率   | 死亡合計 |
|------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|------|
| 1 月份 | 1,027 | 41  | 3.99% | 977   | 50  | 5.12% | 1,564 | 15  | 0.95% | 106  |
| 2 月份 | 966   | 41  | 4.24% | 916   | 27  | 2.95% | 1,491 | 17  | 1.14% | 85   |
| 3 月份 | 1,021 | 28  | 2.74% | 924   | 23  | 2.49% | 1,616 | 16  | 0.99% | 67   |
| 4 月份 | 1,309 | 8   | 0.61% | 957   | 35  | 3.66% | 1,559 | 8   | 0.51% | 51   |
| 5 月份 | 936   | 8   | 0.85% | 792   | 14  | 1.77% | 1,464 | 5   | 0.34% | 27   |
| 6 月份 | 1,601 | 11  | 0.68% | 759   | 8   | 1.05% | 1,305 | 7   | 0.53% | 26   |

## 出售

|      | 品項 | 出售頭數 | 總重量      | 平均重量   |
|------|----|------|----------|--------|
| 1 月份 | 育成 | 324  | 38,669.5 | 119.35 |
| 2 月份 | 育成 | 311  | 35,677.5 | 114.72 |
| 3 月份 | 育成 | 257  | 30,031.5 | 116.85 |
| 4 月份 | 育成 | 293  | 34,155.0 | 116.57 |
| 5 月份 | 育成 | 306  | 35,848.5 | 117.15 |
| 6 月份 | 育成 | 320  | 38,871.0 | 121.47 |

前三個月未使用滄水棒，後三個月使用滄水棒，前後差異明顯增重，死亡率降低

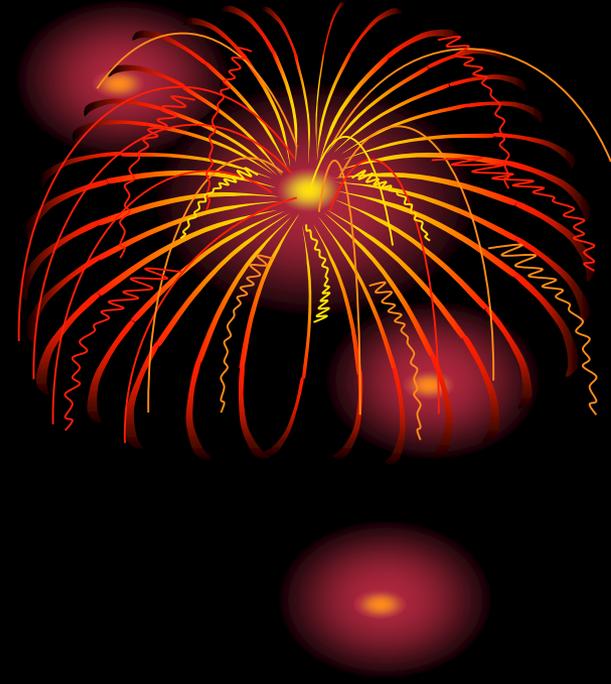

感謝您的參加與聆聽